

さらなる進化を遂げたUnited Imaging社のuMI780のご紹介

112-Ring Digital Light-Guide PETと 128-Slice CTの融合により、鮮明な撮像が低線量/短時間で可能に

日程 2019年4月27日(土)

時間 12:00~13:00

場所 虎ノ門ヒルズフォーラム 第3会場 5F ホール A1

ランチョンセミナーは整理券制となります。

座長

医学博士 **畑澤 順** 先生
大阪大学核物理研究センター

演者

医学博士 **外山 宏** 先生
藤田医科大学 教授

演題


UIH製PET/CT ClariTom uMI510の基礎的研究と使用経験

演者

熊 典 先生
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

演題

Tomorrow's Molecular Imaging Today

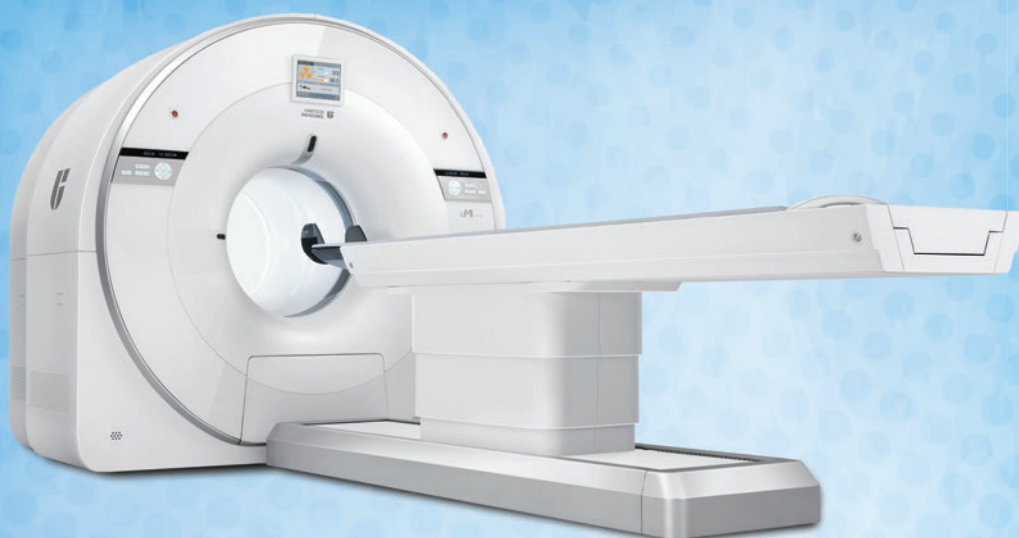

PET/CT装置 ClariTom uMI 780
業事認証名称：PET/CT装置 ClariTom uMI780
医療機器認証番号：第230AABZX00062000号

